

SEM 15883

SEM 15883 Medium Neutral Color Coat Instruction Manual

Model: 15883

1. INTRODUCTION

The SEM Color Coat is a specialized elastomeric coating designed to restore or change the color of various surfaces. It is suitable for most vinyl surfaces, flexible and rigid plastics, carpet, and velour. This product is a fade-resistant, flexible, and permanent coating, not a dye.

2. SAFETY INFORMATION

This product is an extremely flammable aerosol. It is crucial to read and understand all safety warnings before use. Failure to follow these instructions may result in serious injury or property damage.

- **Flammability:** Extremely flammable aerosol. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. Do not smoke during use.
- **Pressurized Container:** May burst if heated. Do not pierce or burn, even after use.
- **Inhalation Hazard:** Vapour is harmful. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing dust, fume, gas, mist, vapours, or spray.
- **Skin and Eye Irritation:** Causes serious eye irritation and skin irritation. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and face protection.
- **Ingestion Hazard:** Harmful or fatal if swallowed. If swallowed, immediately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting.
- **Health Risks:** May cause genetic defects, cancer, or damage to fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
- **Storage:** Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F).
- **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.
- **First Aid:** In case of contact with skin or eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present. If inhaled, move to fresh air. Seek medical attention if irritation persists or if swallowed.
- **Children:** Keep out of reach of children.



EN Danger! Extremely flammable aerosol. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful or fatal if swallowed. Vapor harmful. May cause genetic defects. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Pressurized container. Do not pierce or burn even after use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container in accordance with local / regional / national / international regulations. After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints. After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. After swallowing: If symptoms persist consult doctor. For more information see the MSDS (Material Safety Data Sheet). Keep out of reach of children.

FR Danger! Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut induire des anomalies génétiques. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être protégées du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin. Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique. Maintenez hors de portée des enfants.

ES ¡Peligro! Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar defectos genéticos. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten. Para más información consulte la HDSM (Hoja de datos de seguridad de materiales). Guarde fuera del alcance de niños.

DE Gefahr! Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann genetische Defekte verursachen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Von Hitze/Funkens/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) enthält ausführlichere Informationen. Halten sie aus reichweite der kinder heraus.



EU LEGISLATION	CATEGORY	MAXVOC	ACTUAL
2004/42	IIB(e)	840	686

CONTAINS: acetone (67-64-1), Petroleum gases, liquefied, sweetened (68476-86-8), toluene (108-88-3), 4-methylpentan-2-one (108-10-1).

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

This product is not for use as a food or food contact surface.



Image: Back of the SEM Color Coat can, displaying comprehensive safety warnings and usage precautions in various languages.

3. PRODUCT OVERVIEW

SEM Color Coat is specifically formulated to provide a durable, flexible, and permanent finish that resists fading. It is ideal for restoring the appearance of automotive interiors, marine upholstery, and other items made from vinyl, plastic, carpet, or velour. The Medium Neutral shade (Model 15883) offers a specific color match for various applications.



Image: Front view of the SEM 15883 Medium Neutral Color Coat aerosol can, highlighting the product name and color code.

4. SETUP AND PREPARATION

4.1 Surface Preparation

Proper surface preparation is critical for optimal adhesion and finish quality. All surfaces must be clean, dry, and free of grease, oil, wax, dirt, and other contaminants. Use a suitable cleaner and degreaser specifically designed for the material being coated (e.g., vinyl, plastic, fabric). For best results, lightly scuff rigid plastic or vinyl surfaces with a fine abrasive pad to promote adhesion, then clean thoroughly.

4.2 Masking

Mask off any areas not intended for coating using painter's tape and masking paper or plastic sheeting. Ensure edges are sealed to prevent overspray.

4.3 Environmental Conditions

Apply in a well-ventilated area, preferably outdoors or in a spray booth. Optimal application temperature is between 65°F (18°C) and 90°F (32°C). Avoid applying in direct sunlight, high humidity, or windy conditions, which can affect drying time and finish quality.

5. OPERATING INSTRUCTIONS (APPLICATION)

1. **Shake Can:** Shake the aerosol can vigorously for at least one minute after the mixing ball begins to rattle. Continue to shake periodically during application.
2. **Test Spray:** Before applying to the actual surface, test the spray pattern and color on an inconspicuous area or a similar scrap piece of material.
3. **Application Distance:** Hold the can approximately 8-10 inches (20-25 cm) from the surface.
4. **Apply Thin Coats:** Apply several thin, even coats rather than one heavy coat. Overlap each pass by about 50%. Applying too much product at once can lead to drips, runs, and an uneven finish.
5. **Drying Time Between Coats:** Allow 5-10 minutes flash time between coats. The surface should feel tacky but not wet.
6. **Number of Coats:** Typically, 2-3 light coats are sufficient to achieve full coverage and desired color. Additional coats may be applied if necessary, allowing proper flash time between each.
7. **Full Cure Time:** The coating will be dry to the touch in approximately 30 minutes, but full cure can take up to 24 hours. Avoid heavy use or exposure to moisture during the initial cure period.
8. **Clean Up:** After use, invert the can and spray for a few seconds to clear the nozzle, preventing clogs for future use.

6. MAINTENANCE

Once fully cured, surfaces coated with SEM Color Coat can be cleaned with mild automotive interior cleaners. Avoid harsh chemicals, abrasive cleaners, or stiff brushes, as these may damage the finish. Regular cleaning with a soft cloth and appropriate cleaner will help maintain the appearance of the coated surface.

7. TROUBLESHOOTING

- **Uneven Finish/Mottling:** This can be caused by inconsistent spray distance, insufficient shaking, or applying coats too heavily. Ensure consistent distance, shake the can well, and apply thin, even coats.
- **Drips/Runs:** Occurs when too much product is applied in one area or coats are too thick. Apply lighter, more numerous coats, allowing proper flash time between each.
- **Poor Adhesion:** Usually due to inadequate surface preparation. Ensure the surface is thoroughly cleaned, degreased, and properly scuffed if necessary. Avoid applying over silicone-based products.
- **Rough Texture:** Can result from spraying too far from the surface, allowing the paint to dry slightly before reaching the substrate, or applying in dusty conditions. Maintain proper spray distance and ensure a clean environment.
- **Color Mismatch:** While SEM Color Coat is designed for specific color matching, slight variations can occur due to underlying material color or application technique. Always test on an inconspicuous area first.

8. PRODUCT SPECIFICATIONS

Specification	Detail
Manufacturer	SEM
Brand	SEM
Model Number	15883
Color	Medium Neutral
Item Weight	1 pound
Product Dimensions	8.38 x 5.63 x 7.88 inches
Special Features	Fade Resistant
Date First Available	November 11, 2010



Image: SEM Color Coat can illustrating its approximate dimensions, showing a height of 8.3 inches (20 cm).

9. WARRANTY AND SUPPORT

Specific warranty information for the SEM 15883 Medium Neutral Color Coat is not provided within this document. For detailed warranty terms, technical support, or further product inquiries, please contact SEM Products, Inc. directly through their official website or customer service channels.


This guide from SEM provides detailed procedures for repairing and refinishing automotive plastic parts, including fenders, bumpers, dashboards, and trim. It covers identifying plastic types (flexible, rigid, extra-rigid) and outlines step-by-step instructions using SEM's range of repair materials, primers, and coatings. Includes product lists and standard operating procedures.

A comprehensive guide to SEM Chip Guards, detailing their benefits for protecting automotive panels from impact, chipping, and abrasion. Includes application instructions, standard operating procedures, and a detailed product list of related SEM automotive refinishing products.


Explore detailed technical specifications for the SEM 650B wheel loader, including engine performance, hydraulic system, transmission, dimensions, and capacities. Manufactured by Shandong SEM Machinery Co., Ltd.

Discover the SEM 636D Wheel Loader, a robust and versatile machine from Caterpillar's SEM brand. Learn about its key specifications, efficient hydraulic system, reliable powertrain, and wide range of applications.

Detailed technical specifications for the SEM518 compactor, including engine power, operating weight, dimensions, travel speed, and vibratory system data.

	SEM636D Wheel Loader Operation and Maintenance Manual This comprehensive manual provides essential guidance for the safe and efficient operation, maintenance, and troubleshooting of the SEM636D Wheel Loader. It covers detailed safety information, technical specifications, operational procedures, and maintenance schedules to ensure optimal performance and longevity of the equipment.
--	--


Documents - SEM – 15883

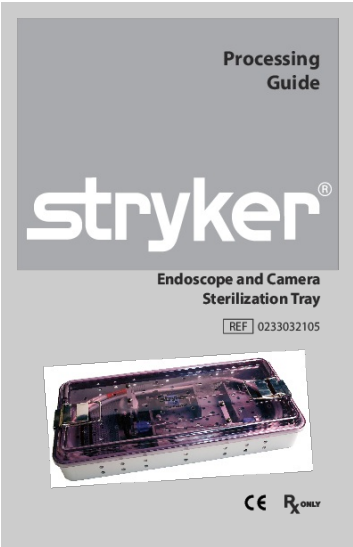

[Stryker Endoscope and Camera Sterilization Tray Processing Guide](#)

This guide provides essential instructions for the proper cleaning, sterilization, and handling of the Stryker Endoscope and Camera Sterilization Tray (REF 0233032105). It details the intended use, required materials, and step-by-step processing procedures, including manual and automated cleaning methods, sterilization parameters, and safety precautions.

lang:nl **score:32** filesize: 7.24 M page_count: 346 document date: 2022-04-26

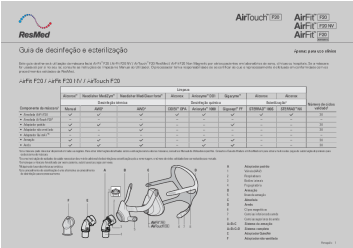

[\[pdf\] User Manual Guide](#)

Manual de desinfecçãoManuais do utilizador e declarações conformidade ResMed Portugal608444 airfit
airtouch f20 disinfection sterilisation guide row pordocument resmed documents products mask 608444
por |||
Guia de desinfeo e esterilizao Apenas para uso clinico Este guia destina-se utilizao da
mscara fac ... ecida cintica de inativao trmica de microrganismos vegetativos
submetidos a desinfeo trmica EN ISO **15883-1** e inclui a combinao de
tempo/temperatura recomendada pela APIC Associao de Profissionais d...
lang:pt **score:30** filesize: 372.89 K page_count: 9 document date: 2024-05-08



[\[pdf\] User Manual Guide](#)

608160 masks sterilisation guide amer por resmed shared assets documents sterilization guides
Apenas para uso clinico Mscaras ResMed Guia de Desinfeo e Esterilizao MSCARAS
NASAIS Mirage ActivaTM ... cara usando uma das combinaes de temperaturatempo2
listadas nas sees a seguir. Com base na prEN ISO **15883-1**, a mscara foi testada s
seguintes combinaes de temperatura/tempo: 70C 158F durante 100 min...
lang:pt **score:29** filesize: 339.01 K page_count: 6 document date: 2007-05-11




[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608160 masks sterilisation guide amer por resmed en us assets documents sterilization guides

Apenas para uso clínico Mscaras ResMed Guia de Desinfecao e Esterilizao MSCARAS NASAIS Mirage ActivaTM ... cara usando uma das combinaes de temperaturatempo2 listadas nas sees a seguir. Com base na prEN ISO **15883-1**, a mscara foi testada s seguintes combinaes de temperatura/tempo: 70C 158F durante 100 min...

lang:pt **score:29** filesize: 323.46 K page_count: 6 document date: 2007-09-17

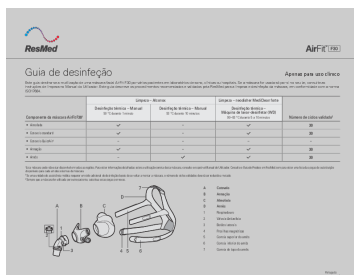

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

Manual do utilizador Manuais e declarações de conformidade para produtos ResMed AirFit F30 airfit f30 disinfection guide row por document resmed documents products serviceandsupport masksterilisation |||

Guia de desinfecao Apenas para uso clínico Este guia destina-se a reutilizao de uma mscara facial Air ... segundos. 3. Transfira os componentes para uma mquina de lavar-desinfetar compatvel com a srie ISO **15883**. 4. Regule a mquina de lavar-desinfetar usando os seguintes parmetros: Fase/Etapa Pr-lavagem ...

lang:pt **score:28** filesize: 253.86 K page_count: 4 document date: 2021-08-23

[pdf] User Manual Guide

Manual de desinfecção Manuais do utilizador e declarações conformidade para produtos ResMed AirFit

F20 Declaração Conformidade cotovelo standard QuietAir conformidade pack configuração AirMini airfit

f20 disinfection sterilisation guide row por document resmed documents products serviceandsupport

masksterilisation |||

Guia de desinfeo e esterilizao Apenas para uso clinico Este guia destina-se ao uso de

uma mscara fa ... ecida cintica de inativao trmica de microrganismos vegetativos

submetidos a desinfeo trmica EN ISO **15883-1** e inclui a combinao de

tempo/temperatura recomendada pela APIC Associao de Profissionais d...

lang:pt score:27 filesize: 287.04 K page_count: 8 document date: 2021-05-21

[pdf] Guide

Decontamination Disinfection and Sterilization Guide for Masks decontamination disinfection sterilization

guide masks 0 medicaldevice airliquide sites alms files 2023 12 |||

FRANAIS Rev. 08/2023 Guide la dcontamination, dsinfection et strilisation Ce guide

dfnit les pr ... ncessaire, un produit de rinage PH neutre. Conformment aux

recommandations de la norme UNI EN ISO **15883:2014**, le cycle du masque doit tre

rgl avec l une des combinaisons de temps et de temprature su...

lang:fr score:26 filesize: 3.57 M page_count: 48 document date: 0000-00-00

[pdf] Instructions Accessories Borchure

View Instructions For Use Intra Oral X Ray Accessories Sensor Holders Trollbyte kimera instructions

scvisionmedical images Brochures |||

Troll Byte Kimera RO Descrierea produsului/domeniul de utilizare: TrollByte Kimera

sunt suporturi d ... ferttlents: Automatizlt Eszkzk Tiszttszer bltszer Vzminsg Utastsok

Mos- s ferttlentgp az EN ISO **15883** szabvny szerint validlva Enzimatikus vagy

alacsony lgtartalm, orvosi eszkzkzhz alkalmas. Nem k...

lang:it score:25 filesize: 1.99 M page_count: 2 document date: 2023-09-13

[pdf] User Manual Guide

608160r19 masks sterilization guide amer por resmed assets documents service support mask us




APENAS PARA USO CLNICO Guia de desinfeo e esterilizao mscaras faciais

mscaras nasais sistemas de ... ados pela ResMed Desinfeo trmica de alto nvel

Desinfeo qumica de alto nvel Esterilizao EN ISO **15883-1** 70C 158F -100 min 75C

167F -30 min 80C 176F -10 min 90C 194F -1 min CIDEXTM OPA Ortofta...

lang:es score:25 filesize: 451.28 K page_count: 3 document date: 2012-02-03

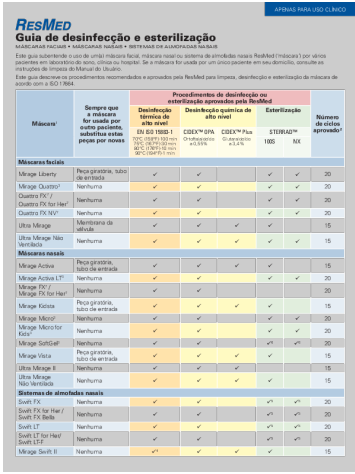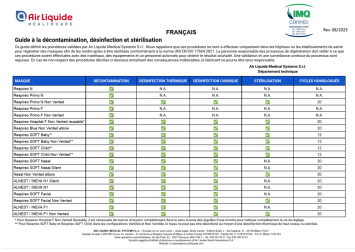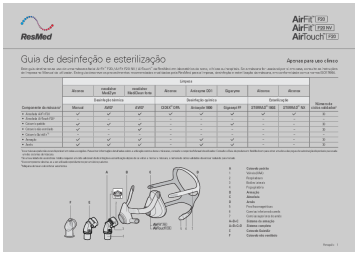

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608402r3 mask disinfection sterilization guide amer por resmed us dam documents products

serviceandsupport masksterilisation

Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia subentende o uso

de um a máscara ... for usada por outro paciente, substitua estas peças por novas

Desinfecção térmica de alto nível EN ISO **15883-1** 70C 158F -100 min; 75C 167F -30 min

80C 176F -10 min; 90C 194F -1 min Desinfecção química ...

lang:es score:25 filesize: 200.22 K page_count: 4 document date: 2017-04-12

[\[pdf\]](#) Instructions Datasheet

Prep Mixing Application Cleanup Instructions SEM Color Coat High Gloss Clear Auto Body Toolmart sem

tds color coat autobodytoolmart tech sheets |||

COLOR COAT™ TECHNICAL DATA SHEET Check local VOC regulations to ensure

compliance of all products ... 453 15483 15603 15643 15713 15723 15753 15763

15793 15803 15813 15823 15833 15843 15853 15863 15873 **15883** 15893 Color

Coat Color Coat Color Coat Color Coat Color Coat Color Coat Color Coat Color

Coat...

lang:en score:25 filesize: 79.78 K page_count: 9 document date: 2015-10-01

[\[pdf\]](#) Guide

Decontamination Disinfection and Sterilization Guide for Masks MDR decontamination disinfection

sterilization guide masks 24 languages mdr medicaldevice airliquide sites alms files 2023 04 |||

FRANCAIS Rev. 03/2023 Guide de la décontamination, de désinfection et de stérilisation Ce guide

dfinit les pr ... ncessaire, un produit de rinage PH neutre. Conformment aux

recommandations de la norme UNI EN ISO **15883**:2014, le cycle du masque doit tre

rgl avec l'une des combinaisons de temps et de température su...

lang:fr score:25 filesize: 3.67 M page_count: 48 document date: 0000-00-00

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608160 masks sterilization guide amer por resmed 80 br assets documents service support mask

APENAS PARA USO CLINICO Guia de desinfeco e esterilizao mscaras faciais

mascaras nasais sistemas de ... os pela ResMed Desinfeco trmica de alto nvel

Desinfecção química de alto nível Esterilização prEN ISO **15883-1** 70C 158F -100 min 75C

167F -30 min 80C 176F -10 min 90C 194F -1 min CIDETM OPA Ortofta...

lang:pt score:25 filesize: 152.43 K page count: 3 document date: 2010-02-01

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608160r28 masks sterilization guide amer por resmed 80 content dam global documents products

serviceandsupport masksterilisation


Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia subentende o uso

de um a máscara ... for usada por outro paciente, substitua estas peças por novas

Desinfecção térmica de alto nível EN ISO **15883-1** 70C 158F -100 min; 75C 167F -30 min

80C 176F -10 min; 90C 194F -1 min Desinfecção química ...

lang:es score:25 filesize: 71.16 K page count: 4 document date: 0000-00-00

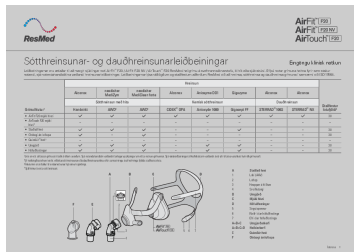


[pdf] User Manual Guide

airfit f20 disinfection sterilisation guide row ice document resmed documents products serviceandsupport masksterilisation |||

Sththreinsunar- og dauhreinsunarleibeiningar Eingngu klnsk notkun Leibeiningarnar eru tlaar til a m ... ullngjandi. 2 treikna og tla fr afvirkjunarhvarfafri um ekkt hrif hita rverur jurtarkinu EN ISO **15883**-1 og undir a fellur tma-hitastigssamsetningin sem APIC Associations for Professionals in Inf...

lang:id **score:25** filesize: 287.7 K page_count: 8 document date: 2021-05-25

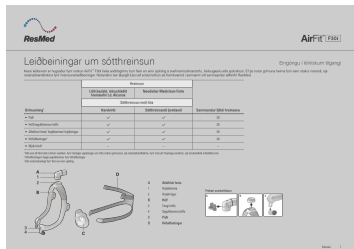


[pdf] User Manual Guide

airfit f30i disinfection guide row ice document resmed documents products mask |||

Full face mask Leibeiningar um stthreinsun Eingngu klnskum tilgangi essi leiarvsir er hugsaur fy ... um a innra yfirbor eininga s skola. 3. Flyttu einingarnar stthreinsandi vottavl sem samrmist ISO r **15883**. Sna skal einingum til a tryggja a a leki vel r eim. 4. Stilltu stthreinsandi vottavlina me ef...

lang:no **score:25** filesize: 259.59 K page_count: 3 document date: 2019-10-28

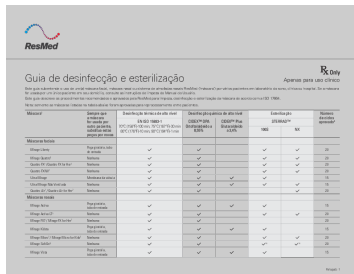


[pdf] User Manual Guide

608160 masks sterilization guide amer por resmed 80 content dam global documents products machine s9 series disinfection and

Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia subentende o uso de um a mscara ... for usada por outro paciente, substitua estas peas por novas Desinfeco trmica de alto nvel EN ISO **15883**-1 70C 158F -100 min; 75C 167F -30 min 80C 176F -10 min; 90C 194F -1 min Desinfeco qumica ...

lang:es **score:25** filesize: 70.62 K page_count: 4 document date: 0000-00-00

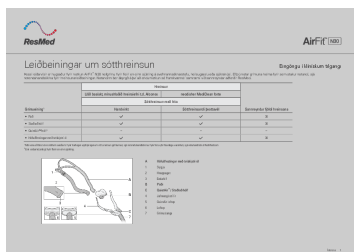


[pdf] User Manual Guide

airfit n30 disinfection guide row ice document resmed documents products serviceandsupport masksterilisation |||

Leibeiningar um stthreinsun Eingngu klnskum tilgangi essi leiarvsir er hugsaur fyrir notkun AirFi ... um a innra yfirbor eininga s skola. 3. Flyttu einingarnar stthreinsandi vottavl sem samrmist ISO r **15883**. Setji stalaa rammabnainn arastt3 til a auvela vatnsfli gegnum grmuslnguna. Sna skal eining...

lang:no **score:25** filesize: 188.25 K page_count: 3 document date: 2020-01-14

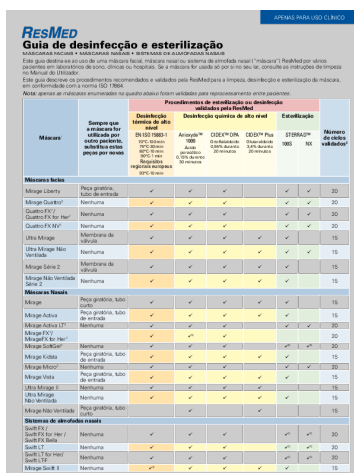

[pdf] User Manual Guide

608156r15 masks sterilisation guide row por resmed assets documents service support mask sterilization

APENAS PARA USO CLNICO Guia de desinfeco e esterilizao mscaras faciais mscaras nasais SISTEMAS DE ... ados pela ResMed Desinfeco trmica de alto nvel Desinfeco qumica de alto nvel Esterilizao EN ISO **15883**-1 70C-100 min 75C-30 min 80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus AnioxydeTM 1000 c...

lang:es **score:25** filesize: 354.5 K page_count: 4 document date: 0000-00-00

608156r17 masks sterilisation guide row por resmed assets documents service support mask sterilization
APENAS PARA USO CLNICO Guia de desinfeco e esterilizao mscaras faciais
mscaras nasais SISTEMAS DE ... sinfeco validados pela ResMed Desinfeco trmica
de alto nvel Desinfeco qumica de alto nvel EN ISO **15883-1** 70C-100 min 75C-30 min
80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus AnioxydeTM 1000 c...
lang:pt score:24 filesize: 553.46 K page_count: 4 document date: 0000-00-00

608418 masks sterilisation guide row por resmed assets documents service support mask sterilization
ResMed Confidential Proprietary Information, not to be reproduced or made available
to third parties ... ea giratria, tubo curto Pea giratria, tubo de entrada Nenhuma
Desinfeco trmica de alto nvel EN ISO **15883**-1 70C-100 min 75C-30 min 80C-10 min
90C-1 min Requisitos regionais europeus 93C-10 min Desinf...

608418 masks sterilisation guide row por resmed epn dam documents products serviceandsupport
masksterilisation

Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia destina-se ao u
de uma mscara f ... ea giratria, tubo curto Pea giratria, tubo de entrada Nenhuma
Desinfeco trmica de alto nvel EN ISO **15883**-1 70C-100 min 75C-30 min 80C-10
90C-1 min Requisitos regionais europeus 93C-10 min Desinf...

lang:es score:24 filesize: 163.22 K page_count: 4 document date: 2015-05-01

608639 airfit f30i disinfection guide row ice document resmed documents products mask |||

Full face mask Leibeiningar um stthreinsun Eingngu klnskum tilgangi VIVRUN Alltaf skal fylgja le ... a innra yfirbor eininga s skola. 1. Flytji einingarnar votta- og stthreinsitki sem sammist ISO r **15883**. 2. Stilli votta- og stthreinsitki eftirfarandi htt: Stillingar Sna skal einingum til a tr...

lang:id **score:24** filesize: 325.06 K page count: 4 document date: 2023-11-12

airfit n20 airtouch disinfection guide row por document resmed documents products serviceandsupport
masksterilisation |||

Guia de desinfeção e esterilização Apenas para uso clínico Este guia destina-se ao uso de
uma máscara na ... assegurando a inexistência de bolhas de ar: Almofada/presilhas
magnéticas/cotovelo e tubo curto EN ISO **15883-1** : 70 C durante 100 minutos 75 C
durante 30 minutos 80 C durante 10 minutos 90 C durante ...

lang:pt score:24 filesize: 331.09 K page count: 8 document date: 2019-11-14

[illegible]



Redmi



Air IT

Leibnizianer um sothreinsun

Achse 11 Leibnizianer

Am 1. April 2024 sind die folgenden 11 Leibnizianer in der folgenden Reihenfolge an der Achse 11 erschienen: (Die Reihenfolge ist alphabetisch nach Nachnamen sortiert, wobei die Namen der Teilnehmer in der Reihenfolge, in der sie an der Achse 11 erschienen sind, angegeben sind.)

	Historical Data		Experimental Data (Spring 2024)		Experimental Data (Fall 2024)	
	Reference and/or. Information	Experimental Data (Spring 2024)	Reference and/or. Information	Experimental Data (Fall 2024)	Experimental Data (Fall 2024)	Experimental Data (Fall 2024)
1. Leibnizianer						
• Leibnizianer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Leibnizianer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Leibnizianer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Leibnizianer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Teilnehmer der Achse 11 sind in der folgenden Reihenfolge an der Achse 11 erschienen: (Die Reihenfolge ist alphabetisch nach Nachnamen sortiert, wobei die Namen der Teilnehmer in der Reihenfolge, in der sie an der Achse 11 erschienen sind, angegeben sind.)

[illegible]

REPROCESSING

HAMILTON-BC8010-A

37.0

MAX

MAX

REPROCESSING GUIDE

HAMILTON-BC8010-A, breathing set for HAMILTON-H900, dual limb, heated, with water chamber

©2017/01 | 2016-02-04

HAMILTON MEDICAL
Intelligent Ventilation since 1983

CC 0197

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608156r13 masks sterilisation guide row por resmed assets documents service support mask sterilization

APENAS PARA USO CLINICO Guia de desinfeco e esterilizao mscaras faciais

mascaras nasais SISTEMAS DE ... ados pela ResMed Desinfecção térmica de alto nível

Desinfecção química de alto nível Esterilização EN ISO **15883-1** 70C-100 min 75C-30 min

80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus Anioxyde™ 1000 c...

lang:es score:24 filesize: 455.86 K page_count: 3 document date: 2011-10-18

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

[airfit f30 disinfection guide](#) [row ice document](#) [resmed documents](#) [products](#) [serviceandsupport](#)

masksterilisation |||

Leibeiningar um stthreinsun Aeins til klmskrar notkunar essar leibeiningar eiga vi egar

margir sjk ... andi kranavatni1 30 sekndur. 3. Komi hlutunum fyrir vottavla- og

stthreinsibnai sem uppfyllir ISO **15883** staalinn. 4. Stilli vottavla- og stthreinsibnainnn

eftirfarandi [http: Fasi/stig](http://Fasi/stig) Hringrsartmi ...

lang:no score:24 filesize: 255.32 K page count: 4 document date: 2021-08-23

[\[pdf\]](#) User Manual Instructions

5 Joanne Harwood Ixion Instructions Portuguese Downloads DB Orthodontics Limited for Use We have

our instructions available in a number of different Languages English Swedish Spanish Slovakian v

1649418925 cdn shopify s files 1 0795 5789 |||

Instrues gerais de tratamento, manuseamento e reproprocessamento de instrumentos

Ixon no esterilizados ... sequncias adversas. Avisos Utilize um lavador-desinfetador

que cumpra os requisitos da norma ISO **15883**, partes 1 e 2. O soro fisiológico e os

agentes de limpeza/desinfeção com albedo, cloro, cloro ...

lang:pt score:24 filesize: 294.53 K page count: 5 document date: 2022-03-30

[\[pdf\]](#) Guide

HAMILTON BC8010 A Reprocessing guide for H900 624915 01 hamilton medical dam jcr 4b62f121 dce8

43b0 864e 531f896d7367 Hamilton Medical Guide REPROCESSING 2016 02 04 breathing set dual limb

heated with water chamber en de es fr it ja ru tr zh |||

REPROCESSING Reprocessing Guide HAMILTON-BC8010-A, breathing set for

HAMILTON-H900, dual limb, head ... d. Cleaning should only be carried out in a

cleaning and disinfection device that complies with ISO **15883** and has been proven

to be effective. For supported agents, see Suitable cleaning agents on p...

lang:en score:24 filesize: 5.57 M page count: 76 document date: 2016-02-18

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608474 airfit n20 disinfection sterilisation guide row por resmed epn dam documents products

serviceandsupport masksterilisation

Guia de desinfeção e esterilização Apenas para uso clínico Este guia destina-se ao uso de uma máscara na ... assegurando a inexistência de bolhas de ar: Almofada/presilhas magnéticas/cotovelo e tubo curto EN ISO **15883-1** : 70 C durante 100 minutos 75 C durante 30 minutos 80 C durante 10 minutos 90 C durante ...

lang:pt score:24 filesize: 242.15 K page_count: 6 document date: 2017-04-27

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

608156r14 masks sterilisation guide row por resmed 80 assets documents service support mask

sterilization

APENAS PARA USO CLNICO Guia de desinfeco e esterilizao MSCARAS FACIAIS t MSCARAS NASAIS t SISTEMAS ... ados pela ResMed Desinfeco trmica de alto nvel Desinfeco qumica de alto nvel Esterilizao EN ISO **15883-1** 70C-100 min 75C-30 min 80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus AnioxydeTM 1000 c...

lang:es score:24 filesize: 81.01 K page_count: 3 document date: 0000-00-00

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

[airfit n30i p30i disinfection guide row ice document resmed documents products serviceandsupport](#)

masksterilisation |||

Leibeiningar um stthreinsun Aeins til klmskrar notkunar essar leibeiningar eiga vi egar margir sjk ... andi kranavatni1 30 sekndur. 3. Komi hlutunum fyrir vottavla- og stthreinsibnai sem uppfyllir ISO **15883** staalinn. 4. Stilli vottavla- og stthreinsibnainn eftirfarandi htt: Fasi/stig Hringrsartmi ...

lang:tl score:24 filesize: 293.49 K page_count: 4 document date: 2021-08-23

[\[pdf\]](#) User Manual Guide



608156 masks sterilisation guide row por resmed 80 br assets documents service support mask

sterilization

APENAS PARA USO CLÍNICO Guia de desinfecção e esterilização máscaras faciais máscaras nasais SISTEMAS DE respiração pela BesMed Desinfecção térmica de alto nível

Desinfeco qumica de alto nvel Esterilizao prEN ISO **15883-1** 70C-100 min 75C-30 min 80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus Anioxide™ 1000 c...

lang:pt score:24 filesize: 85.12 K page_count: 3 document date: 2010-03-22

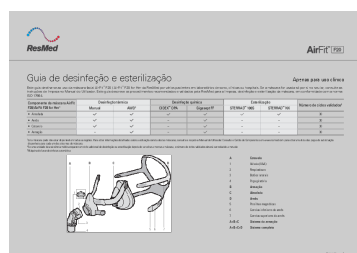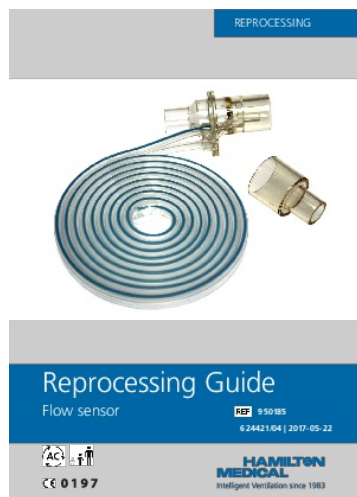

Desinfecção química de alto nível Esterilização EN ISO **15883-1** 70C-100 min 75C-30 min
80C-10 min 90C-1 min Requisitos regionais europeus Anioxyde™ 1000 c...
lang:es score:24 filesize: 1.2 M page count: 3 document date: 2010-09-28

REPROCESSING Reprocessing Guide Flow sensor 950185 624421/04 2017-05-22
Table of Contents En ... d. Cleaning should only be carried out in a cleaning and
disinfection device that complies with ISO **15883** and has been proven to be effective.
The disinfectant must have cleaning connectors injectors ...
lang:en score:24 filesize: 1.91 M page count: 104 document date: 2017-05-16


Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia subentende o uso de um a mscara ... for usada por outro paciente, substitua estas peas por novas

Desinfeco trmica de alto nvel EN ISO **15883**-1 70C 158F -100 min; 75C 167F -30 min 80C 176F -10 min; 90C 194F -1 min Desinfeco qumica ...

lang:es score:24 filesize: 157.98 K page_count: 4 document date: 2020-03-19

Guia de desinfeco e esterilizao Apenas para uso clnico Este guia destina-se ao uso da mscara facial ... passveis de serem desinfetados de molho usando uma combinao de temperatura/tempo1: Almofada EN ISO **15883-1** : 70 C durante 100 minutos 75 C durante 30 minutos 80 C durante 10 minutos 90 C durante ...

lang:pt score:24 filesize: 180.9 K page_count: 7 document date: 2017-03-01

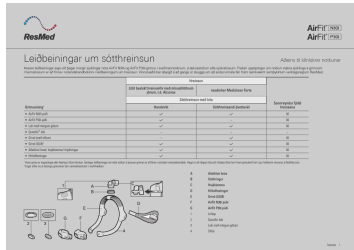


[\[pdf\]](#) User Manual Guide

airfit n30i p30i with quietair disinfection guide row ice document resmed documents products serviceandsupport masksterilisation |||

Leibbeiningar um sththreinsun Aeins til klmskrar notkunar essar leibeiningar eiga vi egar margir sjk ... andi kranavatni 1 30 sekndur. 3. Komi hlutunum fyrir vottavla- og sththreinsibnai sem uppfyllir ISO **15883** staalinn. 4. Stilli vottavla- og sththreinsibnainn eftirfarandi htt: Fasi/stig Hringrsartmi ...

lang:no **score:24** filesize: 244.83 K page_count: 4 document date: 2021-03-18

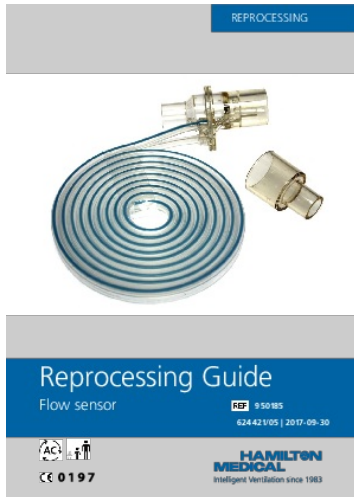

[\[pdf\]](#) User Manual Guide

Autoclavable flow sensor reprocessing guide mpalmieri ACFS en 624421 02 hamilton medical dam jcr d6556197 6c45 4ea9 8bf4 48768200cc9c Hamilton Medical 05 7 Manual cleaning 1 Clean the components in an ultrasound bath prior to normal as described Ultrasound on page 6 2 Submerge solution and let it soak for time defined by manufacturer of disi nfection or agent Cidezyme Flow autoclavable |||

REPROCESSING Reprocessing Guide Flow sensor 950185 624421/05 2017-09-30 Table of Contents En ... d. Cleaning should only be carried out in a cleaning and disinfection device that complies with ISO **15883** and has been proven to be effective. The disinfectant must have cleaning connectors injectors ...

lang:en **score:23** filesize: 1.46 M page_count: 104 document date: 2017-09-22




[\[pdf\]](#) User Manual Guide

Expiratory valve set autoclavable Reprocessing guide mpalmieri Guide Руководство по повторной 624591 06 2017 09 30 Adult Pediatric Neonatal Aufbereitungsvorschrift de retraitement reprocessing en fr it es pt ru tr zh hamilton medical dam jcr 75e774a1 28b0 4cde b75b a7895da97120 |||

Reprocessing Guide Aufbereitungsvorschrift Guide de retraitement Gua de reprocesamiento Guida alla r ... e can be assured. Mechanical cleaning should only be carried out in a device that complies with ISO **15883** and has been proven to be effective. Place the expiratory valve set components in such a manne...

lang:en **score:22** filesize: 2.45 M page_count: 172 document date: 2017-09-28


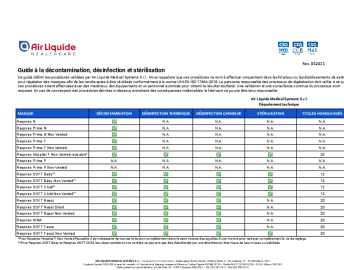


[\[pdf\]](#) Guide

Decontamination disinfection and sterilization guide for masks 17 languages decontamination 3 in medicaldevice airliquide sites alms files 2022 09 |||

Rev. 062021 Guide la dcontamination, dsinfection et stérilisation Ce guide dfinit les procdures vali ... ncessaire, un produit de rinage PH neutre. Conformment aux recommandations de la norme UNI EN ISO **15883:2014**, le cycle du masque doit tre rgl avec l une des combinaisons de temps et de temprature su...

lang:fr **score:22** filesize: 2.72 M page_count: 34 document date: 0000-00-00

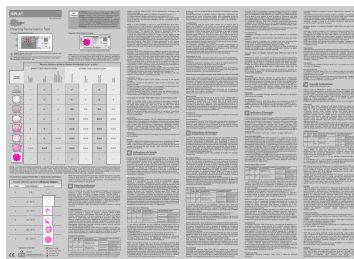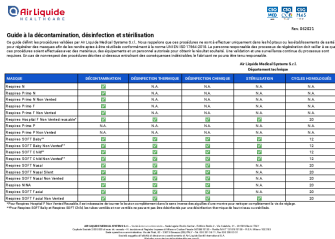

SPLAT Rev. 23 / 07.2021 Cleaning Performance Test Chemdye Splat CDWAH
Holder ATTENTION: If your c ... cacy. The indicators efficiency is validated by
comparing against the test soils detailed in ISO/TS **15883**-5:2005 standard annexes.
5 80 - 100 Explanation of Symbols LOT Batch number. CE mark. A...
lang:en **score:21** filesize: 1.01 M page_count: 2 document date: 2021-07-22

lang:pt score:21 filesize: 382.36 K page_count: 5 document date: 2024-04-19