

EN PREEMIE: OFC 26 - 32 CM (10 - 13 IN)

Indications for Use:

The EyeMax2 provides neonatal eye protection during ultraviolet (UV) phototherapy treatment of jaundice. The EyeMax2 conforms with EN 170:2002 Clause 5.2 (Scale Number 2-5) for spectral transmittance as appropriate for the indication for use.

Instructions for use:

1. Measure Occipital-Frontal Circumference (OFC) of the patient.
2. Select the appropriate EyeMax2 size based on the OFC. See chart for appropriate sizing.
3. Disconnect the Velcro.
4. Position the eye pads over the eyes.
5. Pass the lower strap under the small of the neck and attach velcro.
6. Secure the Velcro of both straps and position the EyeMax2 as shown.
7. Make sure the strap completely covers the ears.
8. If the eye patch rides up away from the nose, tighten the lower strap.
9. If the eye patch rides down towards the nose and mouth, repeat application process beginning with step 1.

FR PREEMIE: TOUR DE TÊTE 26 - 32 CM (10 - 13 POUCHES)

Indications D'utilisation:

La solution Eyemax2 permet une protection néonatale des yeux lors du traitement par photothérapie UV de l'icère. L'Eymax2 est conforme à la norme EN 170:2002 Clause 5.2 (numéro d'échelle 2-5) pour appareils de transmission spectrale et approuvé pour l'utilisation indiquée.

Mode d'emploi:

1. Mesurez la circonférence occipitale et frontale (COF) du patient.
2. Sélectionnez la taille appropriée de l'Eymax2 en fonction de la COF. Consultez le tableau pour le dimensionnement approprié.
3. Détacher les bandes Velcro.
4. Placer les coussinets oculaires sur les yeux.
5. Passer la bride inférieure sur la nuque de l'enfant et la fixer à l'aide du Velcro. Passer la bride supérieure à l'arrière de la tête et la fixer à l'aide du Velcro.
6. Vérifier la bonne fixation des Velcro et place l'Eymax2 comme illustré.
7. S'assurer que les brides recouvrent complètement les oreilles.
8. Si les coussins oculaires remontent sur le nez, serrer la bride inférieure.
9. Si le pansement oculaire descend vers le nez et la bouche, répétez le processus d'application en commençant par l'étape 1.

DE PREEMIE: OFC 26 - 32 CM (10 - 13 ZOLL)

Hinweise zur verwendung:

Eymax2 bietet neonatalen Augenschutz bei UV-Lichtbehandlung bei Gelbsucht. Eymax2 entspricht EN 170:2002 § 5.2 (Skala-Nr. 2-5) für Lichtdurchlässigkeit, wie für den Verwendungszweck angemessen.

Gebrauchsanleitung:

1. Messen Sie den Okzipital-Stirn-Umfang (OFC) des Patienten.
2. Wählen Sie die angemessene Größe der EyeMax2-Brille auf der Grundlage des OFC aus. Siehe Tabelle für die angemessene Größenbestimmung.
3. Lösen Sie den Klettverschluss.
4. Positionieren Sie die Augenpolster über den Augen.
5. Legen Sie den unteren Riemen um den Nacken und befestigen Sie den Klettverschluss.
6. Befestigen Sie den Klettverschluss beider Riemen und positionieren Sie die EyeMax2 Brille wie dargestellt.
7. Achten Sie darauf, dass der Riemen die Ohren vollständig bedeckt.
8. Wenn die Augenklappe nach oben rutscht, ziehen Sie den unteren Riemen fester an.
9. Wenn die Augenklappe zur Nase und zum Mund nach unten rutscht, wiederholen Sie den Anwendungsvorgang beginnend mit Schritt 1.

⚠ Precautions:

CAUTION: Improper EyeMax2 sizing may lead to patient airway obstruction or inadequate eye protection. The EyeMax2 should only be used while the patient is under the continuous, direct supervision of healthcare professionals.

- ❌ **DO NOT** tug on the EyeMax2 to reposition it. A premature infant's skin is very delicate and can easily rupture. Avoid obstructing the nose. Check regularly to ensure the EyeMax2 is not blocking the patient's airway. The EyeMax2 is not a bandage. Cover any existing skin abrasions with appropriate bandages before use.
- ❌ **DO NOT** over tighten - causing excessive pressure on the eyes. Make sure the strap is covering the ear, not hooked over the ear, and that the ear is not folded over. Replace the EyeMax2 with a new one if it becomes over-stretched. Reuse of this device could cause cross-contamination or product malfunctions.

Catalog # R300P01 Regular: occipital-frontal circumference 33-38 cm in packs of 20.
Catalog # R300P02 Preemie: occipital-frontal circumference 26-32 cm in packs of 20.
Catalog # R300P03 Micro: occipital-frontal circumference 20-25 cm in packs of 20.

② **Single Patient Use Only**
Non-Sterile, Latex-Free

⚠ Précautions d'emploi:

MISE EN GARDE: Un mauvais dimensionnement de l'Eymax2 peut entraîner une obstruction des voies respiratoires du patient ou une protection oculaire inadéquate. L'Eymax2 ne doit être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance directe et continue de professionnels de la santé.

- ❌ **NE PAS** tirer brutalement sur l'Eymax2 pour le repositionner. La peau d'un enfant prématuré est très fragile et risque de subir des lésions. ❌ **NE PAS** obstruer le nez. Vérifier régulièrement que l'Eymax2 n'obstrue pas les voies respiratoires du patient.
- ❌ **NE PAS** trop serrer afin de ne pas appliquer une pression excessive sur les yeux. L'Eymax2 ne doit pas servir de bandage. Recouvrir toute lésion cutanée avec des pansements appropriés avant utilisation. S'assurer que les brides recouvrent les oreilles, sans être accrochées et que les oreilles de l'enfant ne sont pas repliées dessous. Remplacer l'Eymax2 par un nouveau s'il se détend. La réutilisation de ce produit peut provoquer une contamination croisée ou un mauvais fonctionnement du produit.

Réf. R300P0 Regular: diamètre fronto-occipital 33-38 cm en kits de 20.
Réf. R300P02 Preemie: diamètre fronto-occipital 26-32 cm en kits de 20.
Réf. R300P03 Micro: diamètre fronto-occipital 20-25 cm en kits de 20.

② **Usage unique**
Non stérile, sans latex


⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

ACHTUNG: Eine falsche Größe der EyeMax2-Brille kann zu einer Behinderung der Atemwege des Patienten oder zu einem unzureichenden Augenschutz führen. Die EyeMax2-Brille ist nur zu verwenden, während sich der Patient unter der ständigen, direkten Aufsicht von medizinischem Fachpersonal befindet.

- ❌ **NICHT** tirer brutalement sur l'Eymax2 pour le repositionner. La peau d'un enfant prématuré est très fragile et risque de subir des lésions. ❌ **NICHT** la Nase blockieren. Kontrollieren Sie regelmäßig den Sitz der EyeMax2 Brille, um sicherzustellen, dass sie nicht die Atemwege blockiert.
- ❌ **NICHT** Zu fest anziehen, um nicht zu viel Druck auf die Augen auszuüben. Die EyeMax2 Brille ist kein Verband. Decken Sie vor dem Gebrauch etwaige Hautabschürfungen mit einem geeigneten Verband ab. Achten Sie darauf, dass der Riemen das Ohr bedeckt, nicht am Ohr verhakt ist, und dass das Ohr nicht umgebogen ist. Ersetzen Sie die EyeMax2 Brille durch eine neue, wenn sie ausgeleiert ist. Die erneute Verwendung dieses Gerätes kann zu Kreuzkontamination oder Fehlfunktion des Produkts führen.

Katalognr R300P0 Regular: Hinterkopf-Stirn-Umfang 33-38 cm in 20-Stück-Packungen.
Katalognr R300P02 Preemie: Hinterkopf-Stirn-Umfang 26-32 cm in 20-Stück-Packungen.
Katalognr R300P03 Micro: Hinterkopf-Stirn-Umfang 20-25 cm in 20-Stück-Packungen.

② **Nur für einen Patienten**
verwenden Nicht steril, latexfrei

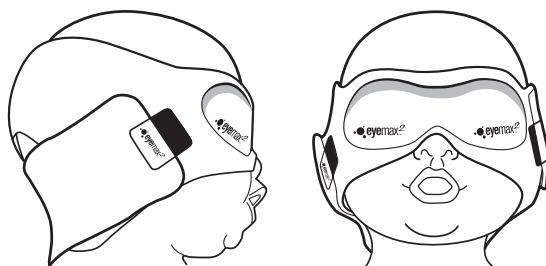

IT **PREMATURI: COF 26 - 32 CM (10 - 13 POLLICI)** ⚠ **Precauzioni:**

Indicazioni Per L'uso:

Eymax2 è una protezione neonatale per occhi che si usa durante il trattamento di fototerapia a raggi ultravioletti (UV) di ittero. Eymax2 è conforme alla Clausola EN 170:2002 5.2 (numero di scala 2-5) per trasmissanza spettrale come adatto secondo l'indicazione d'uso.

Istruzioni per l'uso:

1. Misurare la circonferenza occipitale-frontale (OFC) del paziente.
2. Scegliere la taglia adeguata di EyeMax2 in base alla OFC. Vedere la tabella per le dimensioni adeguate.
3. Aprire il velcro.
4. Posizionare i tamponi per occhi sugli occhi.
5. Passare la cinghia inferiore dietro al collo e applicare il velcro.
6. Fissare il velcro di entrambe le cinghie e posizionare EyeMax2 come indicato.
7. Controllare che la cinghia copra completamente le orecchie.
8. Se il tamponi per occhio si sposta sul naso, stringere la cinghia inferiore.
9. Se la protezione per gli occhi scende verso il naso e la bocca, ripetere il processo di applicazione iniziando dal passaggio 1.

ES **PREEMIE: OFC 26 - 32 CM (10 - 13 PULG)**

Indicaciones de Uso:

La máscara Eymax2 protege los ojos del recién nacido durante el tratamiento de fototerapia contra la ictericia por rayos ultravioleta (UV). Eymax2 cumple con la normativa EN 170:2002 Cláusula 5.2 (escala 2-5) para la transmitancia espectral correspondiente a las indicaciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Mida la circunferencia occipital frontal (COF) del paciente.
2. Seleccione el tamaño correcto de EyeMax2 según la COF. Consulte la tabla para saber el tamaño adecuado.
3. Desconecte el Velcro.
4. Ubique los protectores de ojos sobre los ojos.
5. Pase la banda inferior debajo de la pequeña del cuello y adhiera el velcro.
6. Asegure el Velcro de ambas bandas y posicione el EyeMax2 según se ilustra.
7. Confirme que la banda cubre completamente las orejas.
8. Si el parche ocular se sube y sale de la nariz, ajuste la banda inferior.
9. Si el parche para el ojo cae hacia la nariz y la boca, repita el proceso de aplicación comenzando con el paso 1.

⚠ **Precauzioni:**

PRECAUZIONE: Un posizionamento errato di EyeMax2 può causare l'ostruzione delle vie aeree del paziente o una protezione inadeguata degli occhi. Eymax2 deve essere utilizzato solo mentre il paziente è sotto la supervisione diretta e continua di professionisti sanitari.

❌ **NON** tirare EyeMax2 per prematuro è molto delicata e può rompersi facilmente. Evitare di ostruire il naso. Controllare regolarmente che EyeMax2 non blocchi le vie aeree del paziente. EyeMax2 non è un bendaggio. Coprire le abrasioni cutanee esistenti con bendaggi appropriati prima dell'uso.

❌ **NON** stringere troppo, causando pressione eccessiva sugli occhi. Controllare che la cinghia copra l'orecchio, che non sia agganciata all'orecchio e che l'orecchio non sia piegato. Sostituire EyeMax2 con uno nuovo se ha una tensione eccessiva. Il riutilizzo di questo dispositivo potrebbe causare contaminazione crociata o il malfunzionamento del prodotto.

N. catalogo R300P0 Regular: circonferenza occipito-frontale 33-38 cm in confezione da 20.

N. catalogo R300P02 Prematuri: circonferenza occipito-frontale 26-32 cm in confezione da 20.

N. catalogo R300P03 Micro: circonferenza occipito-frontale 20-25 cm in confezione da 20.

② **Esclusivamente monouso**
Non sterile, senza lattice

⚠ **Precauciones:**

PRECAUCIÓN: Un tamaño incorrecto de EyeMax2 podría obstruir las vías respiratorias del paciente o crear una protección ocular inadecuada. El Eymax2 solo debe utilizarse mientras el paciente está bajo la supervisión continua y directa de profesionales sanitarios.

❌ **NO** tire del EyeMax2 para reposicionarlo. La piel de un bebé prematuro es muy delicada y puede lastimarse fácilmente. Evite obstruir la nariz. Controle regularmente para asegurar que el EyeMax2 no está obstruyendo la vía aérea del paciente.

❌ **NO** sobre-ajuste, provocando excesiva presión sobre los ojos. El EyeMax2 no es un vendaje. Cubra cualquier abrasión existente de piel con los vendajes apropiados antes del uso. Asegúrese de que la banda cubre la oreja, que no está enganchada sobre la oreja y que la oreja no está doblada. Reemplace el EyeMax2 por uno nuevo cuando esté demasiado estirado. La reutilización de este aparato puede provocar contaminación cruzada o fallos en el producto.

Catálogo # R300P0 Regular: circunferencia occipital-frontal 33-38 cm en paquetes de 20.

Catálogo # R300P02 Premie: circunferencia occipital-frontal 26-32 cm en paquetes de 20.

Catálogo # R300P03 Micro: circunferencia occipital-frontal 20-25 cm en paquetes de 20.

② **Para uso en un solo paciente**
No estéril, libre de látex



The Eymax2 is dually noted as a Class I Medical Device and Category 2 PPE device.
EC Type-examination for Directive 89/686/EEC by Notified Body No. 0120:

L'eyemax2 est classé dispositif médical de Classe I et dispositif EPP de Catégorie 2. Dispositif CE d'examen selon la "Directive 89/686/CEE par l'organisme notifié No. 0120:

Eymax2 wurde als Medizinisches Gerät der Klasse I und Kategorie 2 PPE notiert. EG-Untersuchung für Richtlinie 89/686/EWG für benannte Stelle Nr. 0120:

Eymax2 è sia un dispositivo medico di Classe I che un dispositivo PPE di Categoria 2. Esame di tipo CE per Direttiva 89/686/CEE da Ente Certificato No. 0120:

Eymax2 está registrado como Dispositivo Médico de Clase I y como dispositivo EPP Categoría 2. Inspección tipo CE para la Directiva 89/686/CE por el organismo notificado no. 0120:

SGS United Kingdom Limited

Unit 202B, Worle Parkway
Weston Super Mare BS22 6WA
United Kingdom



QNET BV: Kantstraat 19
NL-5076 NP Haaren | The Netherlands



Maxtec | 2305 South 1070 West
Salt Lake City UT 84119
801.266.5300 | www.maxtec.com