

IT
riparazione. Utilizzare solo caricabatterie consigliati 5V 1A, non utilizzare power bank per caricare il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo o l'adattatore se il cavo o la spina sono danneggiati. Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità, calore, fuoco, microonde. Non forzare le spine nelle porte, nelle connessioni o nei pulsanti del dispositivo. Non conservare in macchina, non utilizzarle durante la guida. Luce lampeggiante - rischio di convulsioni, svenimenti e affaticamento della vista per i soggetti con tendenze - consultare un medico. La custodia contiene magneti che potrebbero compromettere il funzionamento dei dispositivi medici. Non aprire il dispositivo. Contiene piccole parti: pericolo di soffocamento.

PT
Os sinais de RF gerados pelo dispositivo podem causar interferências ou avarias de dispositivos médicos, pelo que os leitores eletrónicos não devem ser utilizados perto de dispositivos médicos, em hospitais, estaleiros de construção, aviões, etc. etc. Funda de tela pode alterar o desempenho de RF do dispositivo. Nunca tente reparar o seu dispositivo ou a bateria - contacte o nosso suporte para qualquer reparação. Utilize apenas carregadores recomendados 5V 1A, não utilize power banks para carregar o dispositivo. Não utilize o dispositivo ou o adaptador se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Não exponha o aparelho a água, humidade, calor, fogo, micro-ondas. Não force as fichas nas portas, ligações ou botões do dispositivo. Não o guarde no carro, não o opere enquanto conduz. Luz intermitente - risco de convulsões, desmaios e cansaço ocular para quem tem tendências - consulte um médico. Funda de tela contém ímanes que podem afetar o funcionamento dos dispositivos médicos. Não abra o dispositivo. Contém peças pequenas - perigo de asfixia.

SLO
Radiofrekvenčni signali, ki jih ustvari naprava, lahko povzročijo motnje ali okvaro medicinskih naprav, zato e-brainikov ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav, v bolnišnicah, na gradbiščih, v letalih itd. ali pa se o uporabi posvetujte s proizvajalcem medicinskih pripomočkov, upravljalcem lokacije, kabinskim osebjem itn. Ovirke lahko ovira delovanje RF naprave. Nikoli ne poskušajte popraviti svoje naprave ali njene baterije – za popravilo se obrnite na našo podporo. Uporabljajte samo priporočene polnilnike z močjo 5V 1A, za polnjenje naprave ne uporabljajte power bankov. Ne uporabljajte naprave ali adapterja, če je kabel ali vtič poškodovan. Naprave ne izpostavljajte vodi, vlagi, vročini, ognju, mikrovalovom. Ne vtičajte vtičev v vrata, priključke ali gumb naprave na silo. Ne shranjujte v avtu, ne upravljajte med vožnjo. Utripajoča svetloba - nevarnost epileptičnih napadov, izgube zavesti in utrujenosti oči za tiste, ki imajo težavo s tem, o uporabi v teh primerih se posvetujte z zdravnikom. Ovirke vsebuje magnet, ki lahko vplivajo na delovanje medicinskih naprav. Neodpirajte naprave. Vsebuje majhne dele - nevarnost zadušitve.


CZ
RF signály generované zařízením mohou způsobit rušení nebo poruchu zdravotnických zařízení, takže elektronické čtečky by se neměly používat v blízkosti lékařských zařízení, v nemocnicích, na staveništích, v letadlech atd. nebo použití konzultujte s výrobcem zdravotnických prostředků, majitel, palubní průvodčí atd. Pouzdro může změnit RF výkon zařízení. Nikdy se nepokoušejte opravit své zařízení nebo jeho baterii – s případnou opravou kontaktujte naši podporu. Používejte pouze doporučené nabíječky 5V 1A, k nabíjení zařízení nepoužívejte powerbanky. Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nebo adaptér nepoužívejte. Nevystavujte zařízení působení vody, vlhkosti, tepla, ohně, mikrovln. Netlačte zástrky do portů, připojení nebo tlačítek vašeho zařízení násilím. Neskladujte v autě, nemaniplulujte při řízení. Blikající světlo - riziko záchvatů, ztráta vědomí a únava očí pro osoby se sklony - poraďte se s lékařem. Pouzdro obsahuje magnety, které mohou ovlivnit funkci lékařských přístrojů. Neotevírejte zařízení. Obsahuje malé části - nebezpečí udušení.

SK
RF signály generované zariadením môžu spôsobiť rušenie alebo poruchu zdravotníckych zariadení, preto by sa elektronické čítačky nemali používať v blízkosti zdravotníckych zariadení, v nemocniciach, na staveniskách, v lietadlách atď. majiteľ, palubný sprievodca atď. Puzdro môže zmeniť RF výkon zariadenia. Nikdy sa nepokúšajte opraviť svoje zariadenie alebo jeho batériu – v prípade akékoľvek opravy kontaktujte našu podporu. Používajte iba odporúčané nabíjačky 5V 1A, na nabíjanie zariadenia nepoužívajte powerbanky. Ak je kábel alebo zástrčka poškodená, zariadenie ani adaptér nepoužívajte. Nevystavujte zariadenie vode, vlhkosti, teplu, ohňu, mikrovlnám. Nezasuvajte zástrčky do portov, pripojení alebo tlačidiel vášho zariadenia násilím. Neskladujte v aute, nemanipulujte počas jazdy. Blikajúce svetlo – riziko záchvatov, straty vedomia a únavy očí pre osoby so sklonmi – poraďte sa s lekárom. Puzdro obsahuje magnety, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie zdravotníckych zariadení. Neotvárajte zariadenie. Obsahuje malé časti - nebezpečenstvo udusenía.

NL
De door het apparaat gegenereerde RF-signalen kunnen interferentie of slecht functioneren van medische apparaten veroorzaken. E-readers mogen daarom niet worden gebruikt in de buurt van medische apparaten, in ziekenhuizen, bouwplaatsen, in vliegtuigen, enz. of het gebruik ervan moet worden overlegd met de medische fabrikant, de locatie eigenaar, cabinepersoneel, etc. De hoes kan de RF-prestaties van het apparaat veranderen. Probeer nooit uw apparaat of de batterij te repareren. Neem voor elke reparatie contact op met onze ondersteuning. Gebruik alleen aanbevolen opladers van 5V 1A; gebruik geen powerbanks om het apparaat op te laden. Gebruik het apparaat of de adapter niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Stel het apparaat niet bloot aan water, vochtigheid, hitte, vuur of magnetrons. Forceer de stekkers niet in de poorten, aansluitingen of knoppen van uw apparaat. Niet in de auto opbergen, niet bedienen tijdens het rijden. Flitslicht - risico op epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen voor mensen met neigingen - raadpleeg een arts. De hoes bevat magneten die de werking van medische apparaten kunnen beïnvloeden. Open het apparaat niet. Bevat kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.

UA
Радіочастотні сигнали, що генеруються пристроєм, можуть спричинити перешкоди або несправності у роботі медичних пристроїв, тому електронні пристрої для читання не можна використовувати поблизу медичних пристроїв, у лікарнях, на будівельних майданчиках, у літаках тощо, або проконсультуйтеся з виробником медичного обладнання, сайтом щодо використання, екіпажем літака тощо. Чохол може змінити радіочастотні характеристики пристрою. Ніколи не намагайтеся відремонтувати свій пристрій або його батарею – зверніться до нашої служби підтримки для будь-якого ремонту. Використовуйте тільки рекомендовані зарядні пристрої 5V 1A, не використовуйте павербанки для зарядки пристрою. Не використовуйте пристрій або адаптер, якщо шнур або вилок пошкоджені. Не піддавайте пристрій впливу води, вологості, тепла, вогню, мікрохвиль. Не вставляйте сторонні об'єкти в порти, роз'єми або кнопки пристрою силою. Не зберігайте в автомобілі, не використовуйте під час руху. Миготливе світло - ризик судом, втрати свідомості та втоми очей для схильних людей - проконсультуйтеся з лікарем. Чохол містить магніти, які можуть впливати на роботу медичних пристроїв. Не відкривайте пристрій. Містить дрібні деталі - небезпека задиху.


WARRANTY CARD
Standard warranty - 12 months from purchase date. Extended warranty available from resellers, please contact reseller or distributor.




SOLARIS

QUICK START GUIDE

SAFETY and WARRANTY CARD

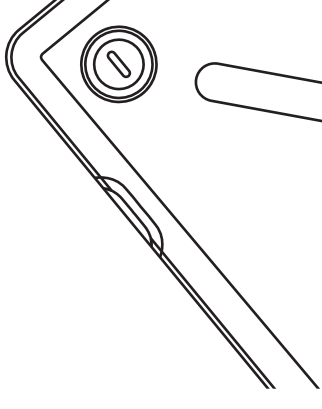

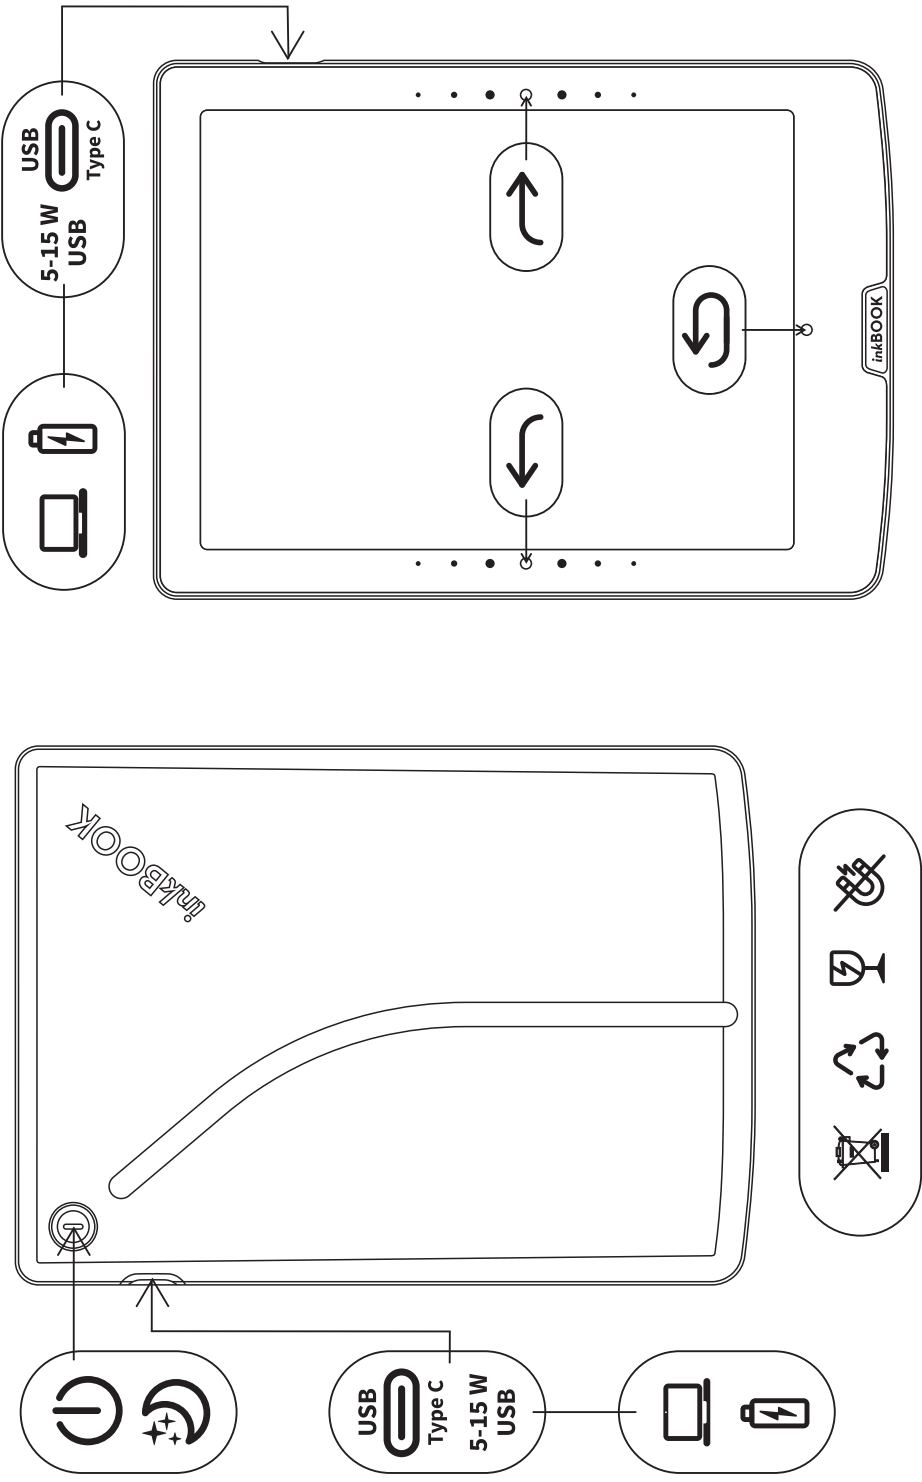

The RF signals generated by device can cause interference with or malfunction to medical devices, so e-readers shall not be used near medical devices, at hospitals, construction sites, in planes, etc. or the use shall be consulted with medical manufacturer, site owner, cabin crew, etc. Covers may change the RF performance of the device. Never attempt to repair your device or it's battery - contact our Support for any repair. Use only recommended chargers 5V 1A, do not use power banks to charge the device. Do not use device or adapter if the cord or plug is damaged. Do not expose the device to water, humidity, heat, fire, microwaves. Do not force plugs into your device ports, connections or buttons. Do not store in car, do not operate while driving. Flashing light - risk of seizures, blackouts, and eyestrain for those with tendencies - please consult a physician. Covers contain magnets which may impact the functioning of medical devices. Do not open the device. Contains small parts - choking hazard.

EN

Les signaux RF g n r s par l'appareil peuvent provoquer des interf rences ou un dysfonctionnement des dispositifs m dicaux, les liseuses ne doivent donc pas  tre utilis s   proximit  d'appareils m dicaux, dans des h pitaux, des chantiers de construction, dans des avions, etc. ou l'utilisation doit  tre consult e avec le fabricant m dical, le propri taire du site, le personnel de cabine, etc. Les  tuis peuvent modifier les performances RF de l'appareil. N'essayez jamais de r parer votre appareil ou sa batterie - contactez notre support pour toute r paration. Utilisez uniquement les chargeurs recommand s 5V 1A, n'utilisez pas de power-banques pour charger l'appareil. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur si le cordon ou la fiche est endommag . N'exposez pas l'appareil   l'eau,   l'humidit ,   la chaleur, au feu, aux micro-ondes. Ne forcez pas les objets dans les ports, connexions ou boutons de votre appareil. Ne stockez pas dans la voiture, ne utilisez pas en conduisant. Lumi re clignotante - risque de convulsions, d' vanouissements et de fatigue oculaire pour les personnes ayant des tendances - veuillez consulter votre m decin. Les  tui contiennent des aimants qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des dispositifs m dicaux. N'ouvrez pas l'appareil. Contient de petites pi ces - risque d' touffement.

FR

Das Ger t nicht im Auto auf und bedienen Sie es nicht w hrend der Fahrt. Blinkendes Licht - bei Personen mit Neigungen besteht die Gefahr von Krampfanf llen, Ohnmachtsanf llen und Augen beranstrengung - konsultieren Sie bitte einen Arzt. Schutztasche enthalten Magnete, die die Funktion medizinischer Ger te beeintr chtigen k nnen.  ffnen Sie das Ger t nicht. Enth lt Kleinteile - Erstickungsgefahr.

DE

Las se ales de RF generadas por el dispositivo pueden causar interferencias o mal funcionamiento de dispositivos m dicos, por lo que los eReader no se deben utilizar cerca de dispositivos m dicos, en hospitales, sitios de construcci n, en aviones, etc. o se debe consultar el uso con el fabricante m dico, el propietario del sitio, la tripulaci n de cabina de aviaci n, etc. Las fundas protectoras pueden cambiar el rendimiento de RF del dispositivo. Nunca intente reparar su dispositivo o su bater a; comuniquese con nuestro Soporte para cualquier reparaci n. Utilice  nicamente cargadores recomendados de 5V 1A, no utilice powerbanks para cargar el dispositivo. No utilice el dispositivo o el adaptador si el cable o el enchufe est n da ados. No exponga el dispositivo al agua, humedad, calor, fuego, microondas. No fuerce los objetos en los puertos, conexiones o botones de su dispositivo. No lo guarde en el autom vil, no lo opere mientras conduce. Luz intermitente: riesgo de convulsiones, desmayos y fatiga visual para personas con tendencia; consulte a un m dico. Las fundas protectoras contienen imanes que pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos m dicos. No abra el dispositivo. Contiene piezas peque as: peligro de asfixia.

ES

DE

Die vom Ger t erzeugten HF-Signale k nnen St rungen oder Fehlfunktionen von medizinischen Ger ten verursachen. E-Reader d rfen daher nicht in der N he von medizinischen Ger ten, in Krankenh usern, auf Baustellen, in Flugzeugen usw. verwendet werden. Die Verwendung muss mit dem Hersteller des Medizinprodukts, dem Standortbesitzer, dem Kabinenpersonal usw. abgesprochen werden. Schutztasche k nnen die HF-Leistung des Ger ts ver ndern. Versuchen Sie niemals, Ihr Ger t oder dessen Akku zu reparieren. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unseren Support. Verwenden Sie nur empfohlene Ladeger te (5 V, 1 A). Verwenden Sie keine Powerbanks zum Laden des Ger ts. Verwenden Sie das Ger t oder den Adapter nicht, wenn das Kabel oder der Stecker besch digt ist. Setzen Sie das Ger t keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit, keiner Hitze, keinem Feuer oder Mikrowellen aus. Stecken Sie Stecker nicht mit Gewalt in die Anschl sse, Verbindungen oder Tasten Ihres Ger ts. Bewahren Sie

I segnali RF generati dal dispositivo possono causare interferenze o malfunzionamenti dispositivi medici, pertanto gli eReader non devono essere utilizzati vicino a dispositivi medici, negli ospedali, nei cantieri, sugli aerei, ecc. o per l'uso   necessario consultare il produttore medico, il proprietario del sito, l'equipaggio di cabina, ecc. La custodia pu  modificare le prestazioni RF del dispositivo. Non tentare mai di riparare il tuo dispositivo o la sua batteria: contatta il nostro supporto per qualsiasi

IT